

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ด้าว สาย พ. ที่ 150/63 (พบ.)

หมายเลข คฉบ. 6550 - M - 63 - S - 0050

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจหาท็อกซินชนิดเอ และชนิดบี ของเชื้อคลอสเตรียม ดิฟฟิไซด์
(Clostridium Difficile Toxin A and B)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาท็อกซินชนิดเอ (Toxin A) และท็อกซินชนิดบี (Toxin B) ของเชื้อคลอสเตรียม ดิฟฟิไซด์ (Clostridium Difficile) เชิงคุณภาพ เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอาการท้องเสีย ประเภท ACC (Antibiotic Associated Colitis) และประเภท PMC (Pseudomembranous Colitis)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) ด้วยเทคโนโลยี Immunochromatography โดยใช้วิเคราะห์ภายนอกร่างกาย

1.2.2 ใช้สิ่งส่งตรวจประเภท อุจจาระ และ Culture Supernatant

1.2.3 สามารถอ่านผลการทดสอบได้ภายใน 15 นาที

1.2.4 มีความไวเท่ากับ 100% และมีความจำเพาะเท่ากับ 91% เมื่อเทียบกับหลักการ ELISA

1.2.5 ความสามารถในการตรวจความเข้มข้นต่ำสุดของชุดทดสอบ ดังนี้

1.2.5.1 Toxin A 4 ng/ml

1.2.5.2 Toxin B 2 ng/ml

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นชุดน้ำยา มีลักษณะเป็นตลับทดสอบ (Test Cassette) สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ให้ผลชัดเจนและถูกต้อง ด้วยแถบควบคุมสีแดง – ม่วง บริเวณตำแหน่งควบคุม (C) และ แถบอ่านผลสีแดง – ม่วง บริเวณตำแหน่งอ่านผล (T) ตำแหน่งแสดงผลของแถบควบคุมและแถบอ่านผล แสดงอยู่บนแถบทดสอบในตัวตลับทดสอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารกำกับระบุชื่อเบนไซด์ รายละเอียดส่วนประกอบ และวิธีการเก็บรักษา

3.2 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 ชุดทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น CE

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแคดด้าลีอิก

/คณะกรรมการ...

พ.อ.

- ๙ ม.ค. ๒๕๖๓

หน้า 2 ใน 2 หน้า

150/63 (พบ.)

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจหาท็อกซิน ชนิดเอ และชนิดบี ของเชื้อคลอสเตรดิเมิล ติพพิไซร์
(Clostridium Difficile Toxin A and B)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. พอ. กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงศ์)

พ.อ. หญิง พอ. กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ. ทก. รพ.ค่ายสุรนารี/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รัญพฤทธิ์ สายบุ่งคล้า)

- 9 ม.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พ.อ. ต. พทศ.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. พอ. กอง พบ./กรรมการ
(ปักเจริญ แสงสว่าง)

พ.อ. นปภ. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทร์พิพ)

23 ม.ค. 2563

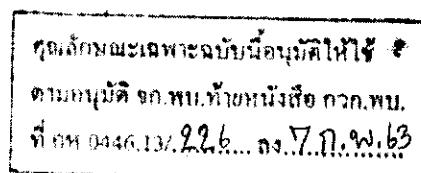

ที่ ๗๘๙/๒๕๖๓

พ.อ.
(รัญพฤทธิ์ สายบุ่งคล้า)
ทก. กพธ. รพ. ค่ายสุรนารี