

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 035/49

หมายเลข คณ. 6530 - M - 62 - P - 1 1 3 9

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค
(Hydraulic Stretcher).

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในห้องผ่าตัดห้องรพทันและหอผู้ป่วยวิกฤต
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค .

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเตียงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ มีแกนไฮดรอลิคเป็นแบบแกนคู่

1.2.2 สามารถปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงได้ ดังนี้

1.2.2.1 ปรับระดับความสูงของเตียงขึ้นสูงสุดได้ 90 เซนติเมตรหรือสูงกว่าและปรับระดับให้ต่ำลง
มาได้ถึง 65 เซนติเมตรหรือต่ำกว่า

1.2.2.2 ปรับท่าศีรษะต่ำได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา

1.2.2.3 ปรับท่าศีรษะสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา

1.2.2.4 ปรับท่ายกเข่าสูงได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา .

1.2.2.5 ปรับพนักพิงสูงได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยใช้ระบบแก๊สสปริง

1.2.3 ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร มีระบบเบรกติดตั้งทั้ง 4 ล้อ สามารถล็อกได้
พร้อมกันเมื่อกดล็อกที่ล้อใดล้อหนึ่ง

1.2.4 มียางกันกระแทกที่มุมทั้ง 4 จุด รอบเตียง .

1.2.5 พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทำด้วยเหล็กเคลือบสีหรือเหล็กเคลือบสาร Galvanized หรือโลหะ
ชนิดอื่นที่ดีกว่า

1.2.6 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 170 กก. .

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับด้วยระบบไฮดรอลิค แบบใช้เท้าเหยียบขนาดกว้าง x ยาว
ไม่น้อยกว่า 80 x 200 เซนติเมตร .

1.3.2 มีแป้นเหยียบสำหรับปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงอยู่ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านของเตียง

1.3.3 มีราวกันเตียง 2 อัน ความยาวตลอดเตียง เป็นแบบเหล็กเคลือบสีหรือโลหะชนิดอื่นที่ดีกว่า
ซึ่งสามารถพับเก็บได้ .

1.3.4 มีที่เสียบเสาน้ำเกลือได้ไม่น้อยกว่า 4 จุดรอบเตียง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ.

18 เม.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก
(Hydraulic Stretcher)


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 มีที่รองนอนขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
- 3.2 ที่ฐานล้อใต้เตียงมีที่วางถังออกซิเจนได้อย่างน้อย 1 ถัง
- 3.3 มีฐานครอบปิดที่ฐานเตียงเพื่อป้องกันฝุ่นทำจากพลาสติก
- 3.4 มีเสาแขวนน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลส ชนิด 2 แขน, 4 แขน อย่างละ 1 อัน
- 3.5 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.6 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.7 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก
(Hydraulic Stretcher)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

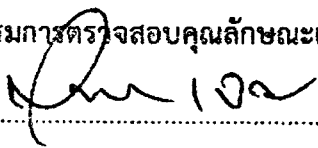
พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ.หญิง..... หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สิริวรรณ สมจินตนา)

18 เมย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทร์มิฬ)

1 พ.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำข.บ.ที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/ 20082 ลง 86.ค.62...