

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 034/60

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - P - 0992

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดอัตโนมัติ
(Endoscope Reprocessor)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับล้างและฆ่าเชื้อโรคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจได้อย่างน้อย 2 กล้องพร้อมกัน

1.2.2 มีระบบการตรวจสอบรอยรั่ว (Leakage Tester) ของตัวกล้องส่องตรวจ

1.2.3 ระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรม

1.2.4 มีระบบกรองน้ำภายในตัวเครื่อง สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.2 ไมครอน หรือดีกว่า

1.2.5 สามารถปรับตั้งอุณหภูมิของน้ำยาฆ่าเชื้อได้

1.2.6 ตัวเครื่องมีระบบการทำงานโดยใช้อัลตราซาวด์อย่างน้อย 3 ตัว หรือระบบ Ultrasonic ในการล้างทำความสะอาด

1.2.7 สามารถเลือกโปรแกรมการทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างน้อย 4 แบบ

1.2.8 มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวเครื่องล้างเพื่อให้ระบบภายในตัวเครื่องปลอดเชื้อ

1.2.9 มีระบบเปิดฝาเครื่องแบบอัตโนมัติ หรือแบบใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิดฝาเครื่อง

1.2.10 มีเครื่องพิมพ์ติดสำเร็จรูปอยู่กับตัวเครื่อง สามารถพิมพ์ข้อมูลการทำงานของตัวเครื่องได้

1.2.11 มีระบบฉีดแอลกอฮอล์ภายในตัวเครื่องล้าง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ตัวเครื่องเป็นชนิดตั้งพื้น มีฝาเปิด-ปิดอยู่ด้านบน ทำจากวัสดุที่มีลักษณะ โปร่งแสงหรือแบบใส สามารถมองเห็นการทำงานภายในเครื่องล้างได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายดาวหรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น CE หรืออื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

22 มี.ย. 2560

พ.จ. 4

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดอัตโนมัติ
(Endoscope Reprocessor)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

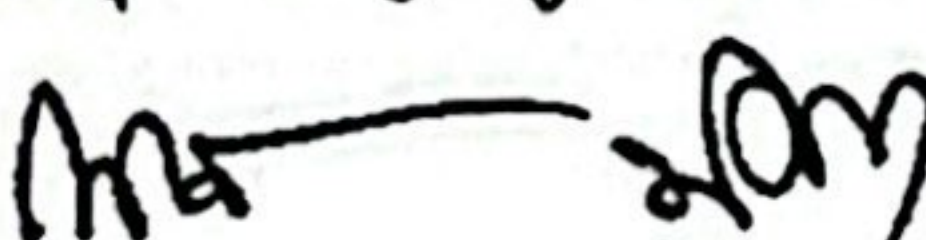
พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ..........อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรนนท์ สรรพจิต)

22 มี.ย. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กฤษตินันท์ บุรณะวิทย์)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ..........นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิม)

20 ก.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/..10693 ลง 22 ส.ค. 60